Gerät – Innen

Unit – Internal

Gerät – Außen

Unit – External

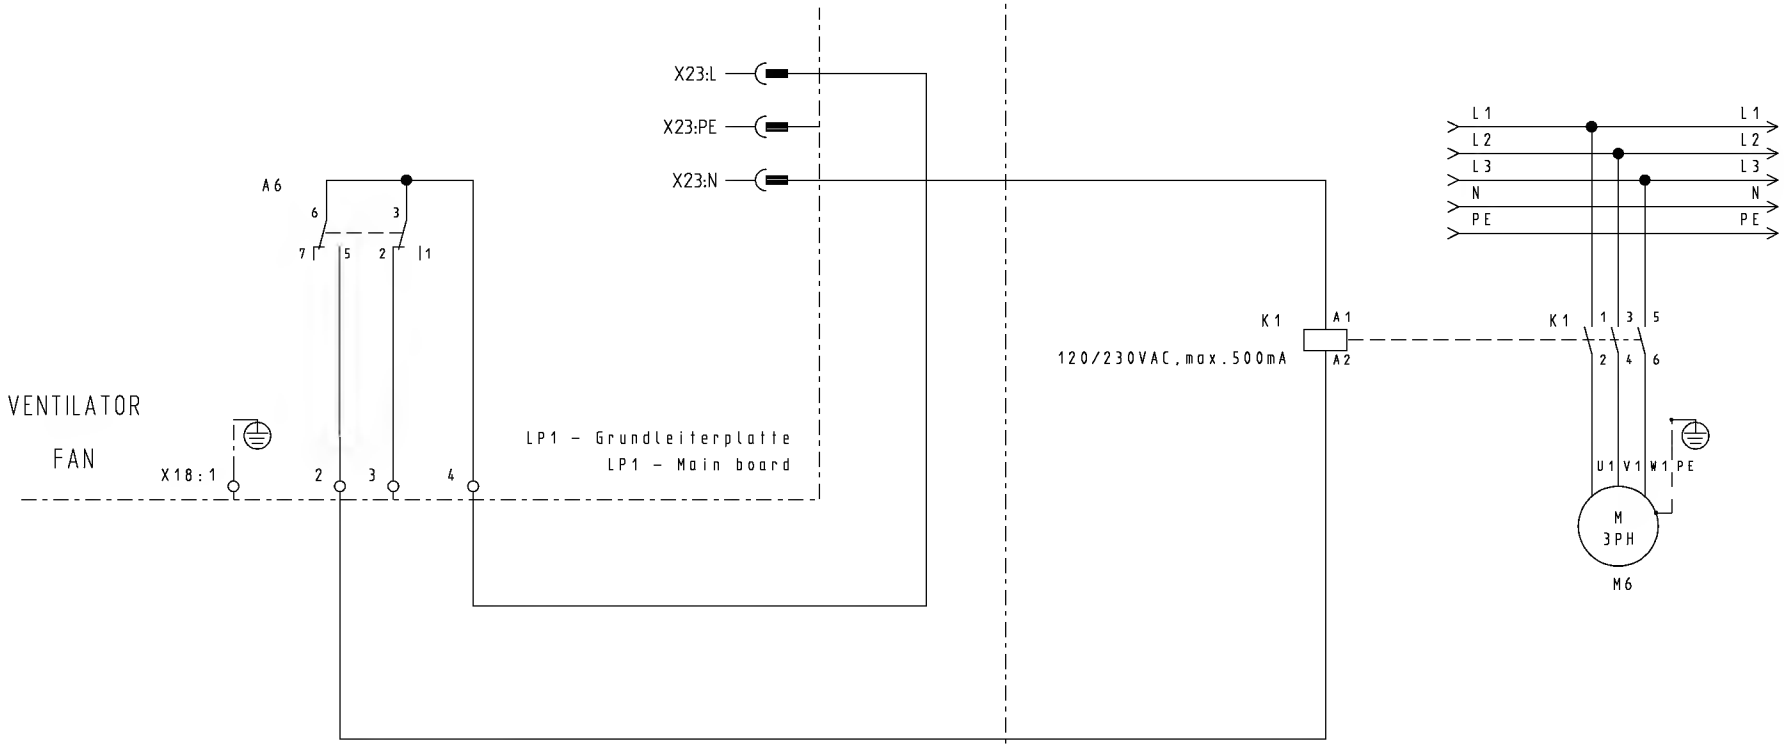

Anschluß eines externen Ventilator

Connection of an external fan

					Bearb.	30.06.03	Mirsu
					Gepr.	11.09.03	Mirsu
A	202908	11.09.03	Mi		Norm		
Ind.	Änderung	Datum	Name			Datum	Name

SP HERAsafe KS(R) EXTERNEN VENTILATOR

PROJEKT: 5007B744-A

Kendro Laboratory Products

Id.-Nr. 50 078 744

A4

Ind. A

Bl. 1

Bl. 2

Gerät – Innen

Unit – Internal

Gerät – Außen

Unit – External

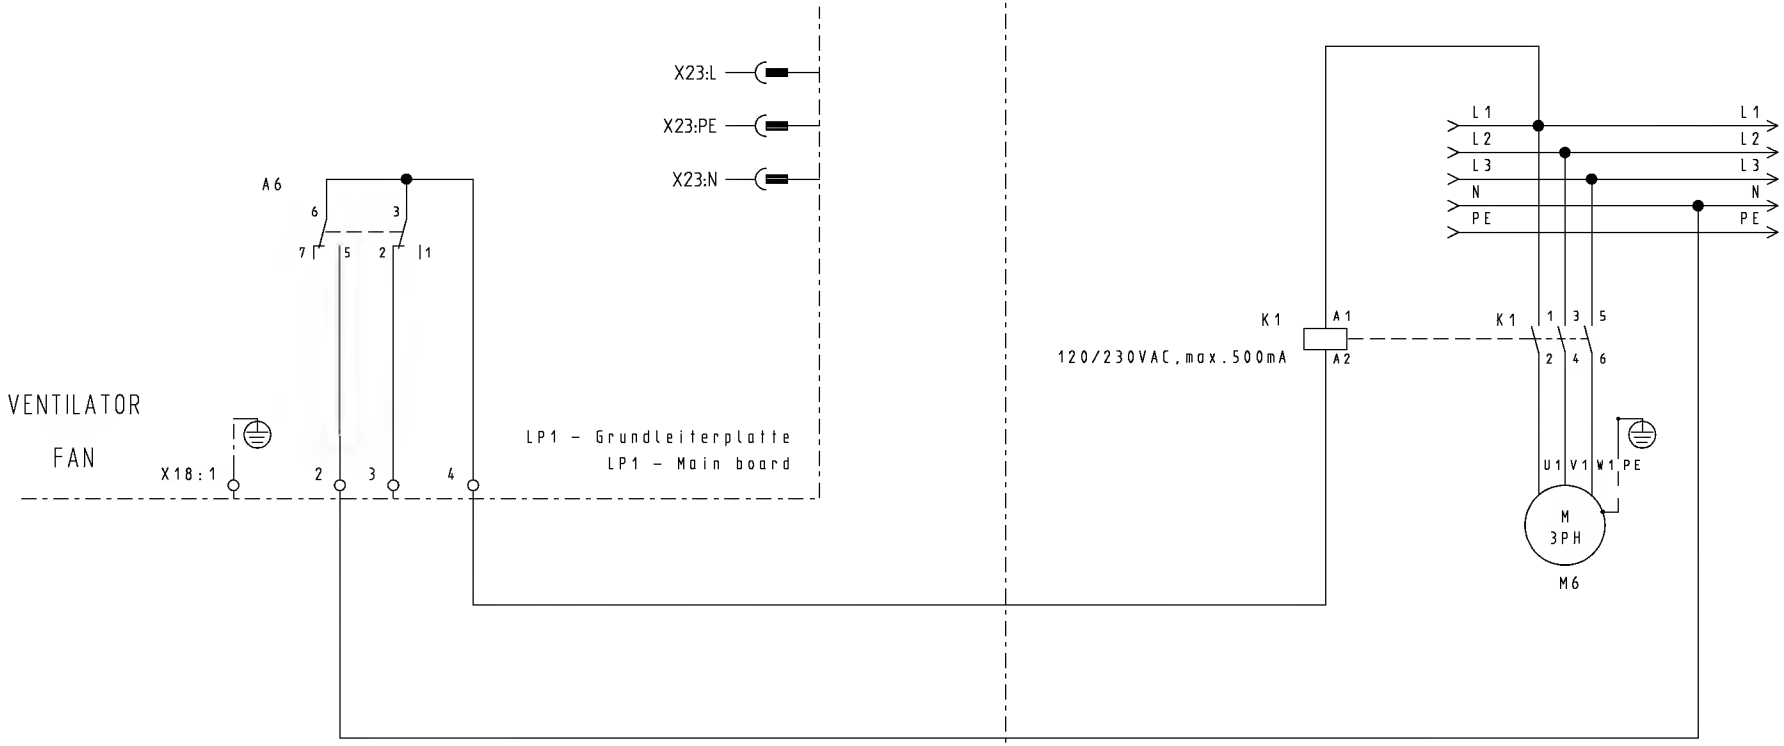

Anschluß eines externen Ventilator

Connection of an external fan

					Bearb.	30.06.03	Mirsu
					Gepr.	11.09.03	Mirsu
A	202908	11.09.03	Mi		Norm		
Ind.	Änderung	Datum	Name			Datum	Name

PROJEKT: 5007B744-A

SP HERAsafe KS(R) EXTERNEN VENTILATOR

Kendro Laboratory Products

Id.-Nr. 50 078 744

A4 | A Ind. | Bl.2 Bl.1.2